

BISCHOFF HPLC-ANLAGE

Gewerbliches Verkaufsangebot · Baujahr 1995



1.490 € netto · VB

Kompaktes historisches HPLC-System mit RI-Detektor, Interface, Säulenthermostat und Software.

Die Anlage wurde nach Angaben des Anbieters nach der Anschaffung wegen eines Fehlkaufs so gut wie nie benutzt.

Gewerbliches Angebot · Verkauf vorzugsweise als komplette Einheit · Abholung bzw. Versand nach Vereinbarung

Kurzbeschreibung

Zum Verkauf steht eine Bischoff HPLC-Anlage aus dem Baujahr 1995. Nach Angaben des Anbieters wurde die Anlage nach der Anschaffung wegen eines Fehlkaufs so gut wie nie benutzt.

Der dokumentierte Lieferumfang umfasst HPLC-Pumpe Modell 2250, RI-Detektor Modell 8120, Interface CaDI 2214, Säulenthermostat „Mistral“ Type 880 und Software McDAcq32 Control.

Technische Übersicht

Komponente	Angabe
Hersteller / Baujahr	Bischoff · Baujahr 1995
HPLC-Pumpe	Modell 2250
Detektor	RI-Detektor Modell 8120
Interface	CaDI 2214
Säulenthermostat	"Mistral" Type 880
Software	McDAcq32 Control

Ihre Vorteile


- Nahezu unbenutzt nach Angaben des Anbieters
- Komplettes, zusammengehöriges HPLC-System
- Interessant für Laboranwendungen, Ausbildung, Versuchsaufbauten und Ersatzteilbedarf

Originalaufnahmen

Die folgenden Fotos zeigen die angebotene Anlage und einzelne Komponenten.



HPLC-System mit HPLC- Pumpe, RI-Detektor, Interface, Säulenthmostat und Software · Bild 1

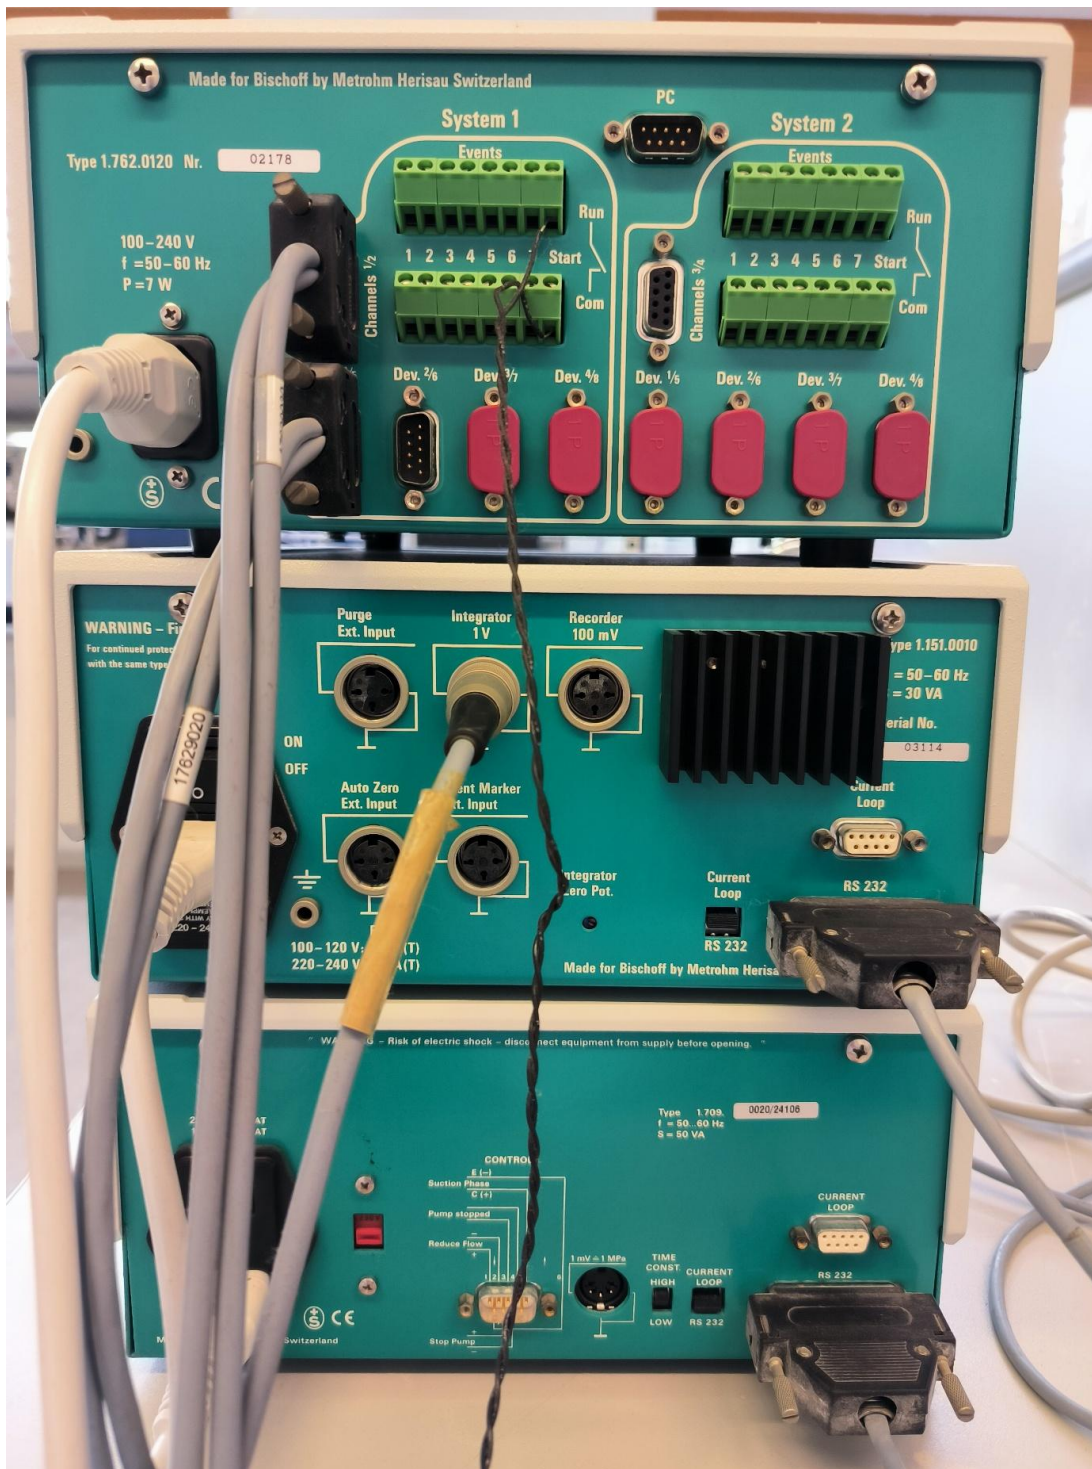

HPLC- Pumpe, RI-Detektor, Interface _hinten · Bild 2



HPLC- Pumpe, RI-Detektor, Interface_vorne · Bild 3



Säulenthermostat_hinten · Bild 4



Säulenthermostat_vorne · Bild 5

Zustand und Funktionsstatus

Die Anlage wurde nach Angaben des Anbieters so gut wie nie benutzt. Aufgrund des Baujahrs 1995 ist die geringe Nutzung jedoch nicht gleichbedeutend mit einer aktuellen technischen Funktionsgarantie.

In der vorliegenden Dokumentation ist keine aktuelle Funktionsprüfung dokumentiert. Vor Inbetriebnahme sollte das System technisch geprüft und gegebenenfalls gewartet werden.

Gewerbliches Angebot

Angebotspreis: 1.490 € netto VB.

Die gesetzliche Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet.

Abholung bzw. Versand, Verpackung und Transport nach Vereinbarung.

Anbieter

Laboratorium Lacher

Niedermattenstraße 3
79238 Ehrenkirchen
Germany
Inhaber: Max Gass

Tel.: +49 (0)7633 982234
E-Mail: max.gass@laboratorium-lacher.de
Web: www.laboratorium-lacher.de